



## Настройка вида сторожевого геркона.

1. Запустите программу. Нажмите кнопку «Режим программирования»

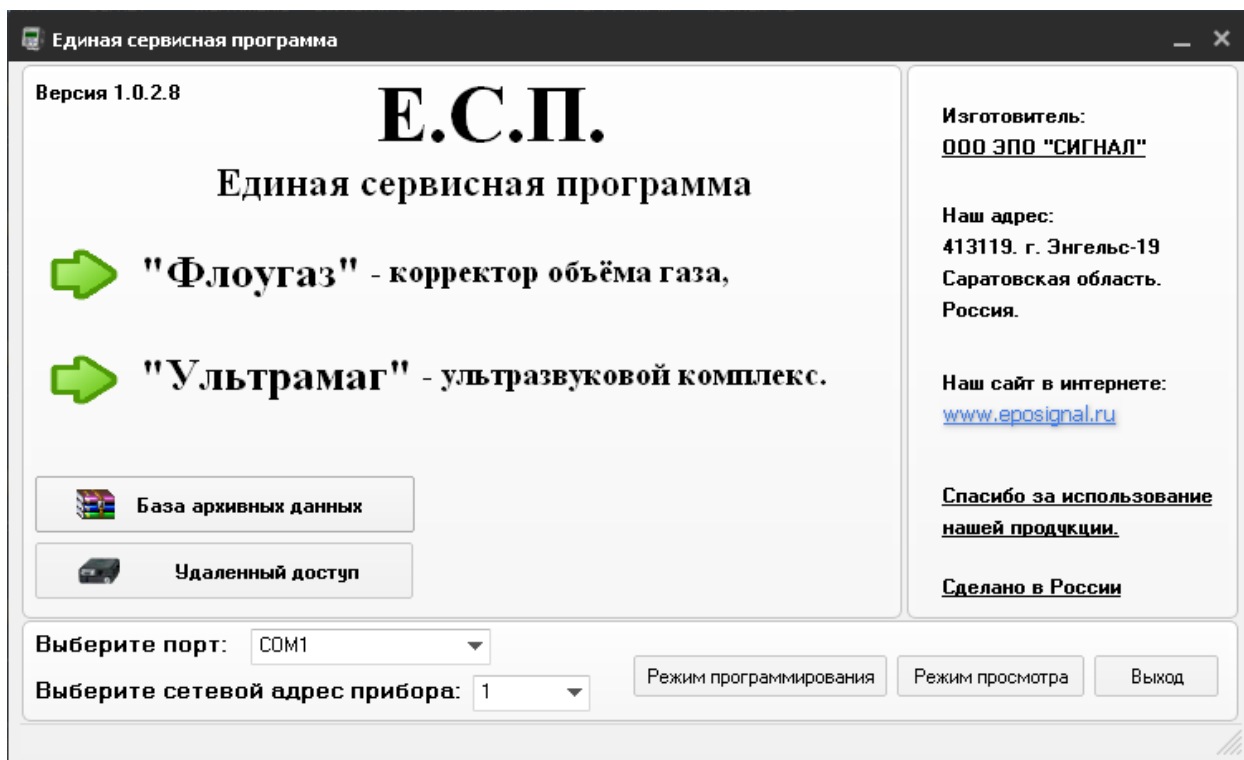

2. В открывшемся окне выберите пункт меню «Параметры настройки» и нажмите кнопку «ОК»

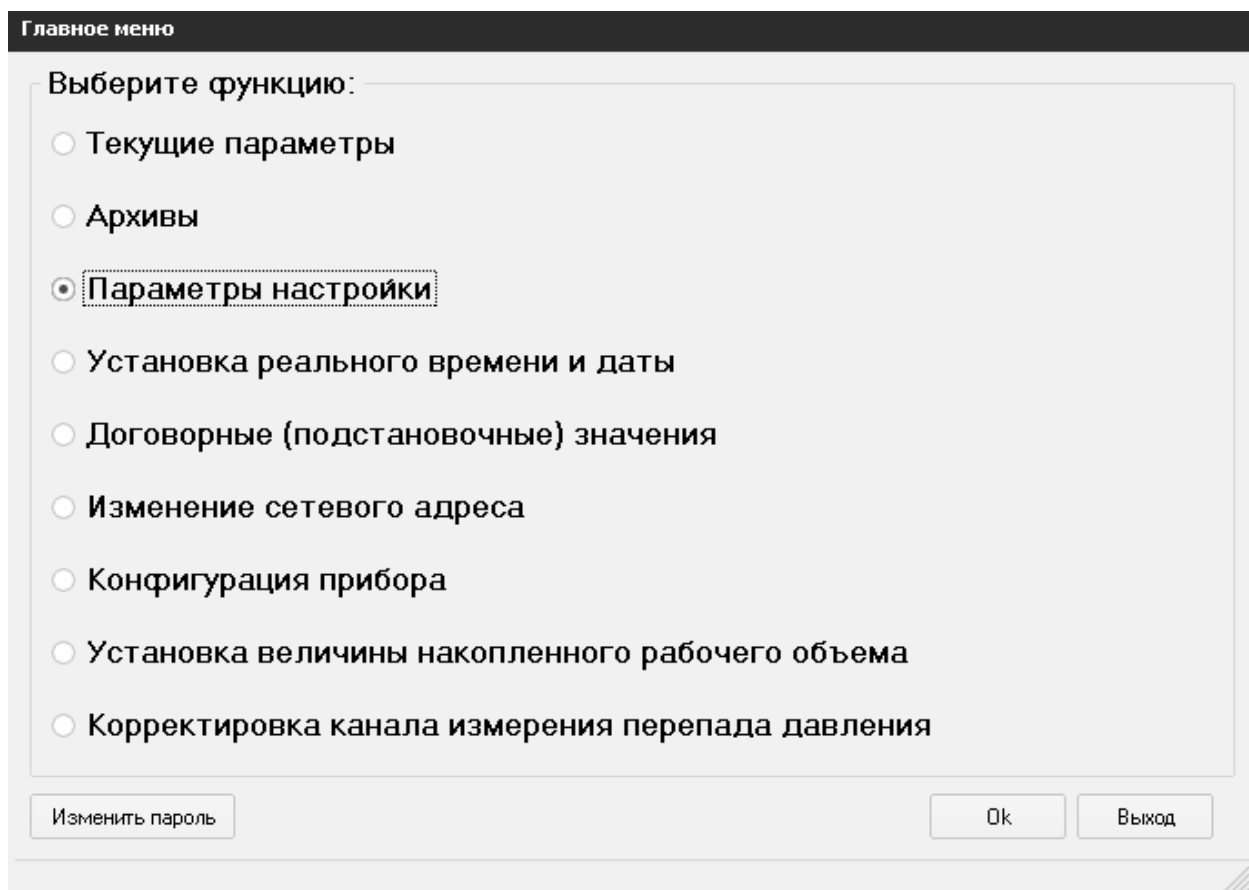

3. В окне «Параметры» выберите вкладку «Дополнительные параметры»

**Параметры**

Основные параметры | **Дополнительные параметры**

Название предприятия (не более 30 символов)  
ООО ЭПО Сигнал

Время индикации : 60 сек.

Датчик перепада давления:  Включен  
 Отключен

Записать | Выход

4. Во вкладке «Дополнительные параметры» выберите вид сторожевого геркона «Нормально замкнут» и нажмите кнопку «Записать». Нажмите кнопку «Выход».

**Параметры**

Основные параметры | **Дополнительные параметры**

Период измерений : 5 сек.

Контрактный час суток : 10

Вид сторожевого геркона:  Нормально замкнут  
 Нормально разомкнут

Записать | Выход

Для счетчиков производства ООО ЭПО «СИГНАЛ» вид сторожевого геркона должен иметь значение «Нормально замкнут».

При установке корректора Флоугаз на счетчики других производителей, вид сторожевого геркона может иметь другое значение.